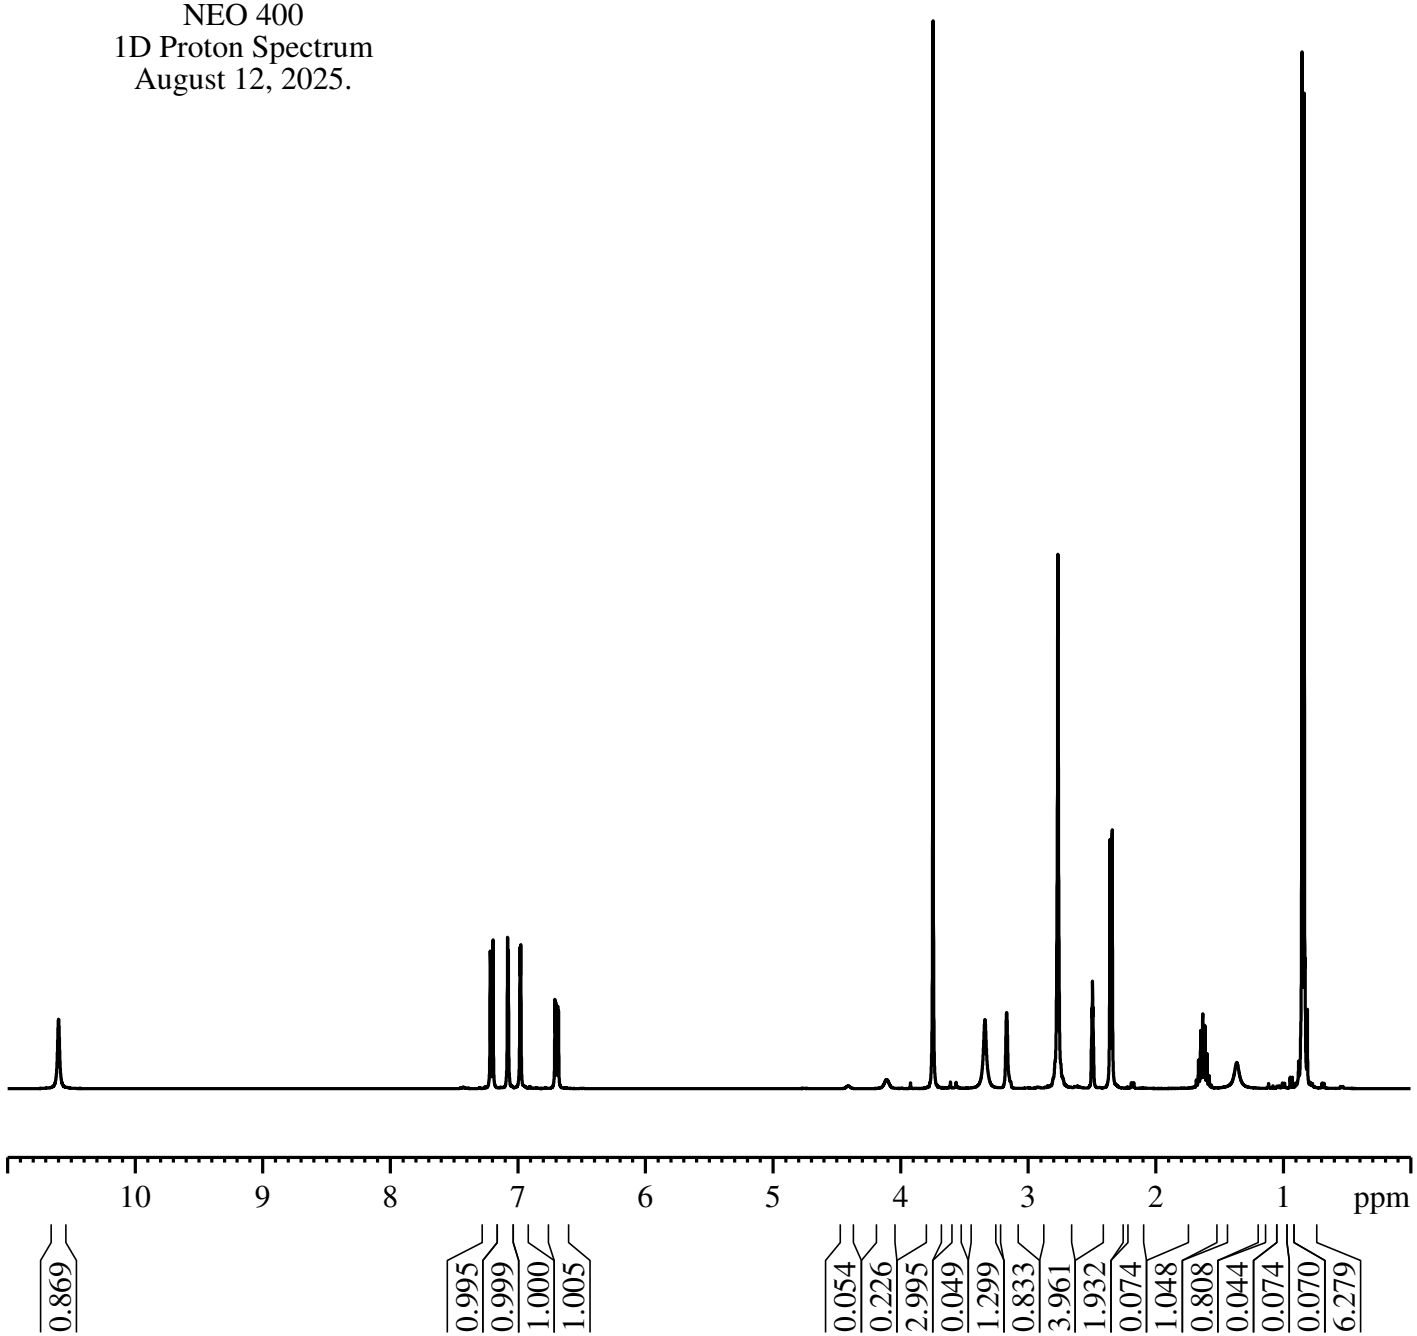
5-MeO-iBT #003 in DMSO-d6
NEO 400
1D Proton Spectrum
August 12, 2025.



Current Data Parameters

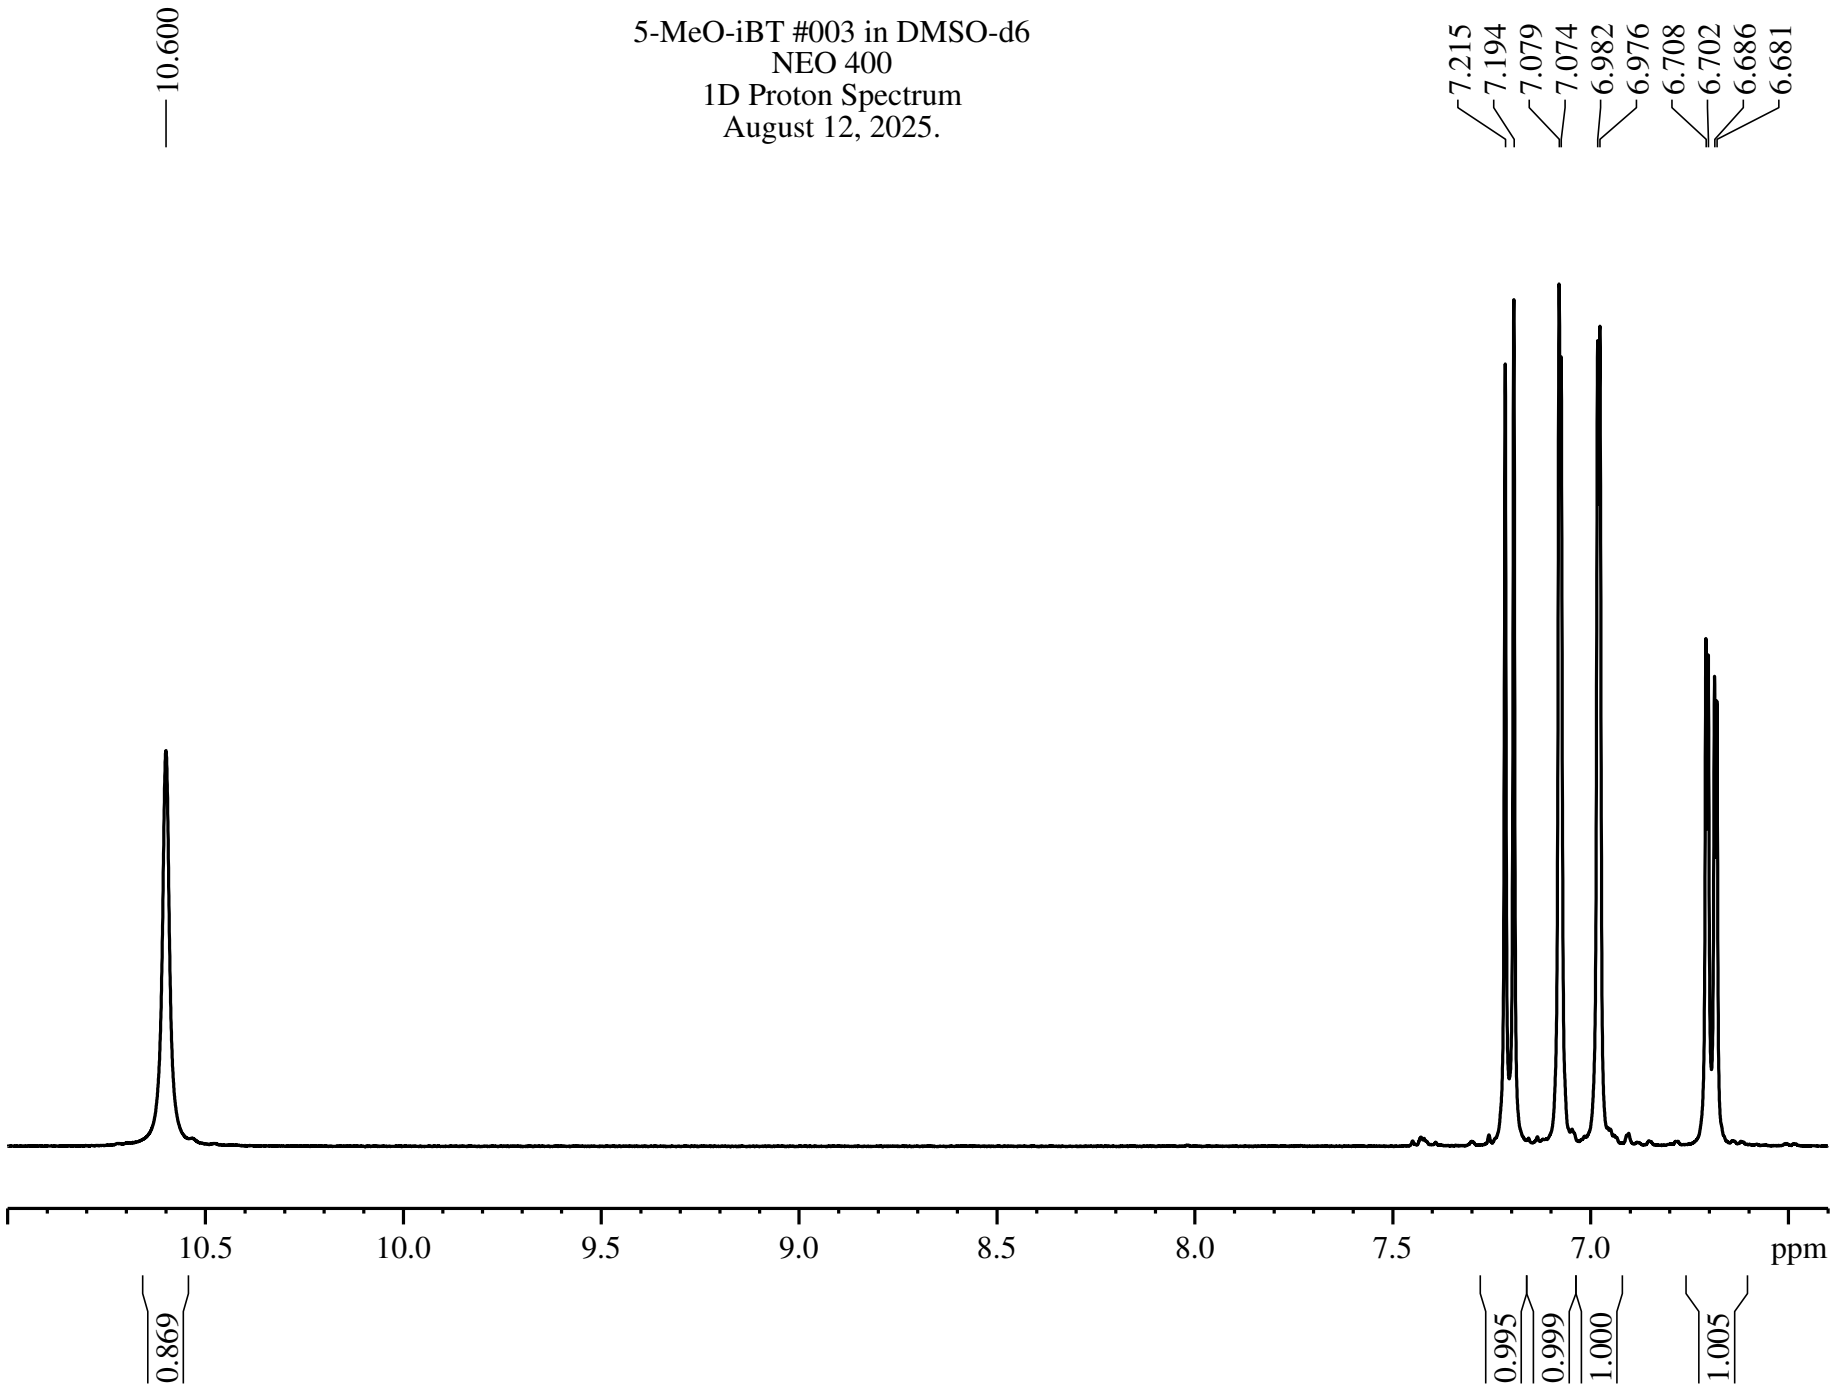
NAME	Syntharise082125
EXPNO	420
PROCNO	1

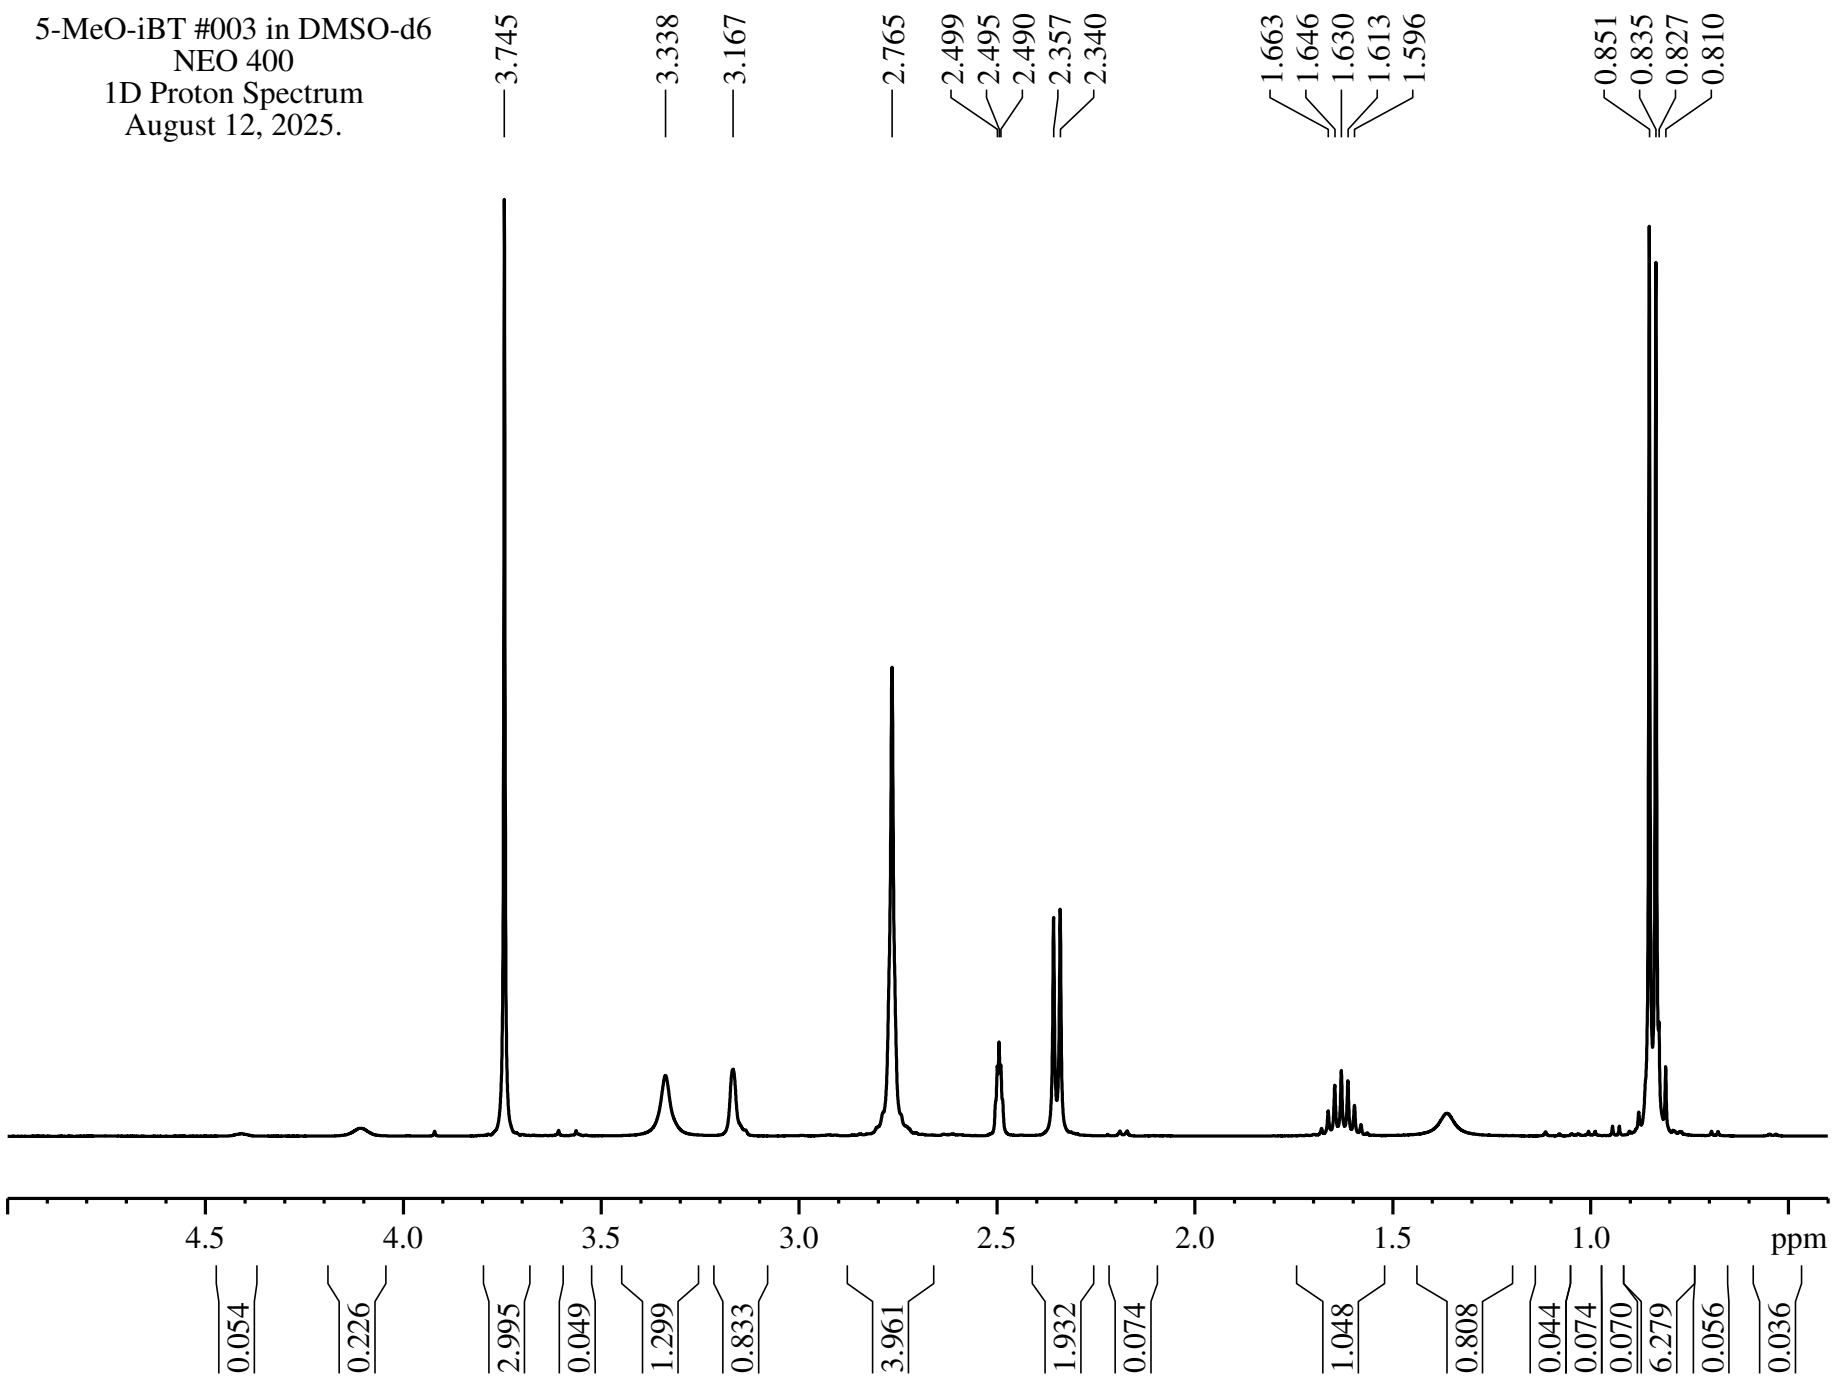
F2 - Acquisition Parameters

Date_	20250821
Time	14.34 h
INSTRUM	Avance Neo 400
PROBHD	Z163739_0039 (PI HR-400-S
PULPROG	zg30
TD	65536
SOLVENT	DMSO
NS	16
DS	0
SWH	8196.722 Hz
FIDRES	0.250144 Hz
AQ	3.9976959 sec
RG	101
DW	61.000 usec
DE	13.54 usec
TE	296.4 K
D1	0.10000000 sec
TD0	1
SFO1	400.3424721 MHz
NUC1	1H
P0	3.33 usec
P1	10.00 usec
PLW1	14.20300007 W

F2 - Processing parameters

SI	65536
SF	400.3400060 MHz
WDW	EM
SSB	0
LB	0.30 Hz
GB	0
PC	1.00


10.600
5-MeO-iBT #003 in DMSO-d6
NEO 400
1D Proton Spectrum
August 12, 2025.
7.215
7.194
7.079
7.074
6.982
6.976
6.708
6.702
6.686
6.681
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
ppm
0.869
0.995
0.999
1.000
1.005


5-MeO-iBT #003 in DMSO-d6
NEO 400
1D Proton Spectrum
August 12, 2025.
3.745
3.338
3.167
2.765
2.499
2.495
2.490
2.357
2.340
1.663
1.646
1.630
1.613
1.596
0.851
0.835
0.827
0.810
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
ppm
0.054
0.226
2.995
0.049
1.299
0.833
3.961
1.932
0.074
1.048
0.808
0.044
0.074
0.070
6.279
0.056
0.036